


Abteilung: FGK / EDV
 Prüf-Nummer:
 Geräteart:
 Gerätebenennung: KIL18440ESS60E

Bearbeiter:
 Sollkurve: 366
 Datum: 22.07.2002 12:16

LL-Versuch ■
 VB-Versuch ●

32 °C
 26 °C
 18 °C
 10 °C

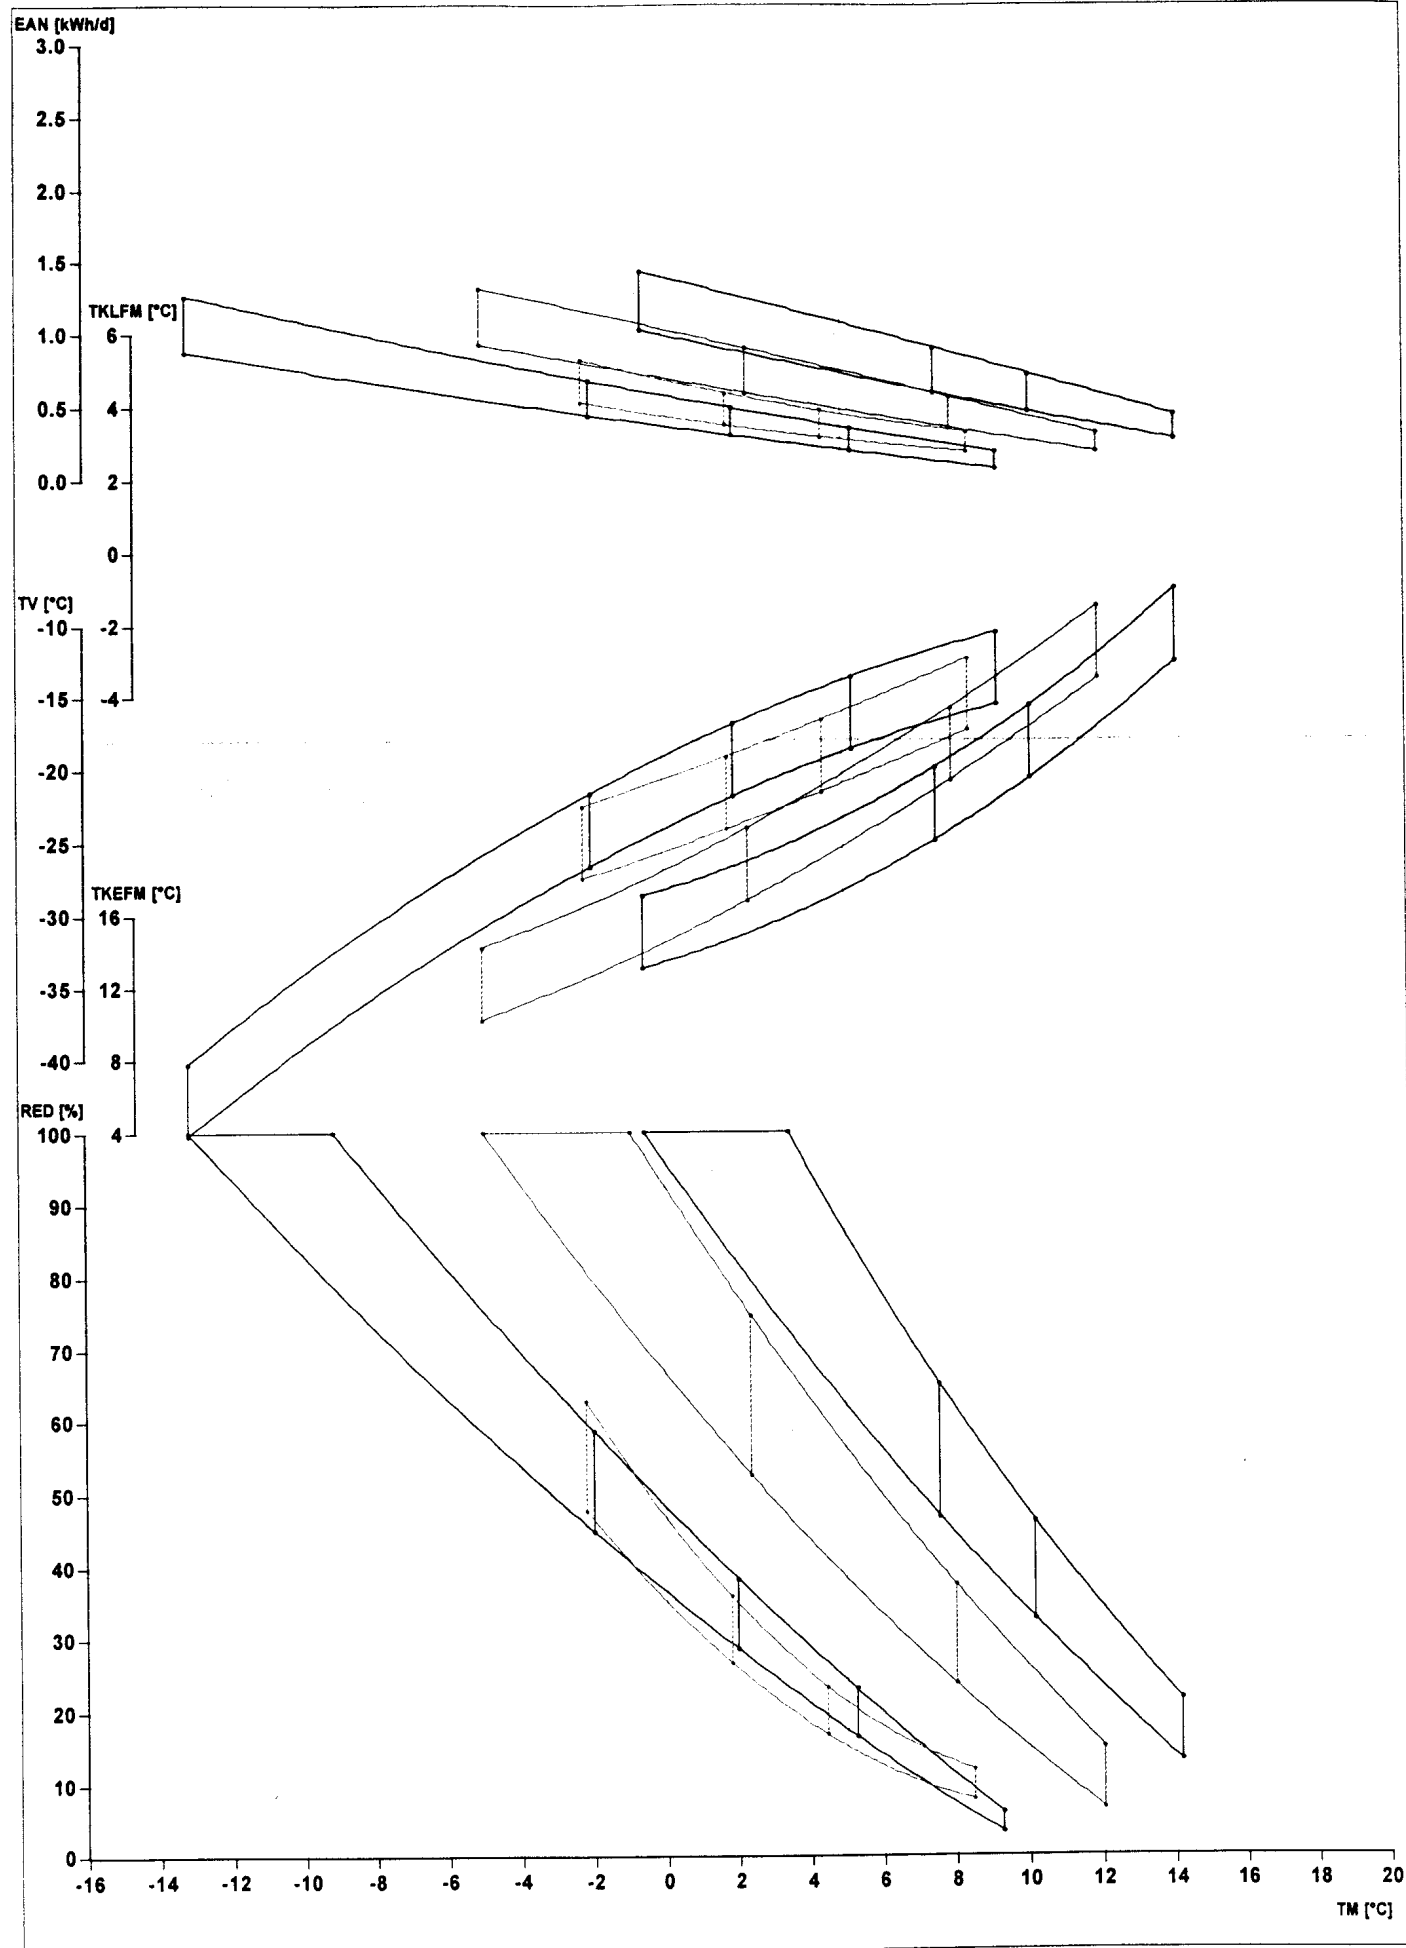

D

57000000008863	Ausg. 07.02
18440-5	50-50/1491